



ZytoLight SPEC MDM2/CEN 12 Dual Color Probe

REF Z-2013-50

5 (0,05 ml)

REF Z-2013-200

20 (0,2 ml)

Pro kvalitativní detekci amplifikací lidského genu MDM2 a alfa satelitů chromozomu 12 pomocí fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH)

4250380P051QN



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro

podle IVD (EU) 2017/746

1. Zamýšlený účel

Dvoubarevná sonda ZytoLight SPEC MDM2/CEN 12 Dual Color Probe (PL18) je určena ke kvalitativní detekci amplifikací lidského genu MDM2 a detekci alfa satelitů chromozomu 12 ve formalinem fixovanych, do parafínu vložených vzorcích, jako je atypický lipomatózní nádor/dobře diferencovaný liposarkom (ALT/WDLPS) a dediferencovaný liposarkom (DDLPS), pomocí fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH). Sonda je určena k použití v kombinaci se sadou ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (prod. č. Z-2028-5/-20).

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Všechny testy s použitím výrobku by mely být prováděny v certifikované, licencované laboratoři anatomické patologie pod dohledem patologa/humánního genetika kvalifikovaným personálem.

Sonda má sloužit jako pomůcka pro diferenciální diagnostiku ALT/WDLPS a DDLPS a terapeutická opatření by neměla být zahajována pouze na základě výsledku testu.

2. Princip testu


Technika fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH) umožňuje detekci a vizualizaci specifických sekvencí nukleových kyselin v buněčných preparátech. Fluorescenčně značené fragmenty DNA, tzv. sondy FISH, a jejich komplementární cílové řetězce DNA v preparátech jsou při hybridizaci společně denaturovány a následně se nechají annealizovat. Poté se nespecifické a nenavázané fragmenty sond odstraní pomocí promývacích kroků. Po protibarvení DNA pomocí DAPI se hybridizované fragmenty sond vizualizují pomocí fluorescenčního mikroskopu vybaveného excitačními a emisními filtry specifickými pro fluorochromy, kterými byly fragmenty sond FISH přímo označeny.

3. Dodaná činidla

ZytoLight SPEC MDM2/CEN 12 Dual Color Probe se skládá z:

- Polynukleotidy značené ZyGreen (excitace 503 nm/emise 528 nm) (~10 ng/μl), které jsou zaměřeny na sekvence mapující oblast 12q15* (chr12:69,071,802-69,565,421), v níž se nachází genový kластer MDM2 (viz obr. 1).
- ZyOrange (excitace 547 nm/emise 572 nm) značené polynukleotidy (~1,5 ng/μl), které cílí na sekvence mapující v 12p11.1-q11 specifické pro alfa satelitní centromerickou oblast D12Z3 chromozomu 12 (viz obr. 1).
- Formamidový hybridizační pufr

*podle sestavy lidského genomu GRCh37/hg19

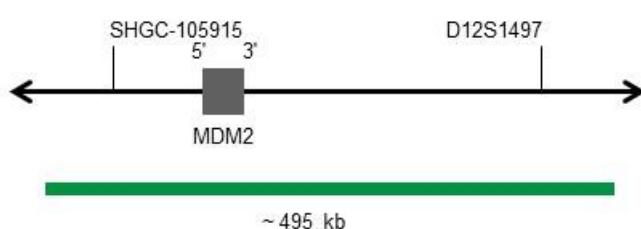

Obr. 1: SPEC MDM2 Mapa sondy (bez měřítka)

ZytoLight SPEC MDM2/CEN 12 Dual Color Probe je k dispozici ve dvou velikostech:

- Z-2013-50: 0,05 ml (5 reakcí po 10 μl)
- Z-2013-200: 0,2 ml (20 reakcí po 10 μl)

4. Požadované, ale neposkytované materiály

- ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit (Prod. č. Z-2028-5/-20)
- Pozitivní a negativní kontrolní vzorky
- Mikroskopická sklíčka, kladně nabité
- Vodní lázeň (37 °C, 98 °C)
- Hybridizér nebo horká deska
- Hybridizátor nebo vlhkostní komora v hybridizační peci
- Nastavitelné pipety (10 μl, 25 μl)
- Barvící nádoby nebo lázně
- Časovač
- Kalibrovaný teploměr
- Etanol nebo reagenční alkohol
- Xylen
- Deionizovaná nebo destilovaná voda
- Krycí sklíčka (22 mm x 22 mm, 24 mm x 60 mm)
- Pryžový cement, např. Fixogum Rubber Cement (prod. č. E-4005-50/125) nebo podobný.
- Vhodně udržovaný fluorescenční mikroskop (400-1000x)
- Ponorný olej schválený pro fluorescenční mikroskopii
- Vhodné sady filtrů

5. Skladování a manipulace

Skladujte při teplotě 2-8 °C ve svíslé poloze chráněné před světlem. Používejte chráněné před světlem. Ihned po použití vratte do skladovacích podmínek. Nepoužívejte činidla po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Při odpovídajícím zacházení je přípravek stabilní až do data použitelnosti uvedeného na štítku.

6. Upozornění a bezpečnostní opatření

- Před použitím si přečtěte návod k použití!
- Nepoužívejte činidla po uplynutí doby použitelnosti!
- Tento výrobek obsahuje látky (v nízkých koncentracích a objemech), které jsou zdraví škodlivé a potenciálně infekční. Vyvarujte se jakéhokoli přímého kontaktu s činidly. Přijměte vhodná ochranná opatření (používejte jednorázové rukavice, ochranné brýle a laboratorní oděv)!

- Jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v souvislosti s výrobkem, nahlasťte výrobcu a příslušnému úřadu v souladu s místními předpisy!
- Pokud se činidla dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím vody!
- Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list materiálu.
- Reagencie nepoužívejte opakovaně, pokud není opakované použití výslovně povolen!
- Vyvarujte se křížové kontaminace vzorků, protože to může vést k chybám výsledků.
- Sonda by neměla být delší dobu vystavena světlu, zejména silnému světlu, tj. všechny kroky by měly být prováděny pokud možno ve tmě a/nebo s použitím nádob odolných proti světlu.

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

Složkou určující nebezpečnost je formamid.



Nebezpečí

| | |
|-----------|---|
| H351 | Podezření, že způsobuje rakovinu. |
| H360FD | Může poškodit plodnost. Může poškodit nenariozené dítě. |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. |
| P201 | Před použitím si vyžádejte zvláštní pokyny. |
| P202 | Nemanipuluje s ním, dokud si nepřečtete a neprozumíte všem bezpečnostním pokynům. |
| P260 | Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance. |
| P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje. |
| P308+P313 | Pokud je vystaven nebo znepokojen: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření. |
| P405 | Sklad je uzamčený. |

7. Omezení

- Pro diagnostické použití *in vitro*.
- Pouze pro profesionální použití.
- Pouze pro neautomatizované použití.
- Klinická interpretace jakéhokoli pozitivního barvení nebo jeho nepřítomnosti musí být provedena v kontextu klinické anamnézy, morfologie, dalších histopatologických kritérií a také dalších diagnostických testů. Za znalost sond FISH, reagencí, diagnostických panelů a metod používaných k výrobě barveného preparátu odpovídá kvalifikovaný patolog/humánní genetik. Barvení musí být prováděno v certifikované licencované laboratoři pod dohledem patologa/humánního genetika, který je odpovědný za revizi obarvených preparátů a zajistění adekvátnosti pozitivních a negativních kontrol.
- Barvení vzorků, zejména intenzita signálů a barvení pozadí, závisí na manipulaci se vzorkem a jeho zpracování před barvením. Nesprávná fixace, zmrazení, rozmrazení, mytí, sušení, zahřívání, řezání nebo kontaminace jinými vzorky či tekutinami může vést k artefaktům nebo falešným výsledkům. Nekonzistentní výsledky mohou být důsledkem rozdílů v metodách fixace a vkládání, jakož i vrozených nepravidelností ve vzorku.
- Sonda by se měla používat pouze pro detekci lokusů popsaných v kapitole 3. "Dodávané reagencie".
- Výkon byl ověřen pomocí postupů popsaných v tomto návodu k použití. Úpravy těchto postupů mohou změnit výkon a musí být ověřeny uživatelem. Tento IVD je certifikován jako CE, pouze pokud je používán způsobem popsaným v tomto návodu k použití v rozsahu určeného použití.

8. Rušivé látky

Červené krvinky přítomné ve vzorku mohou vykazovat autofluorescenci, která brání rozpoznání signálu.

Následující fixativa jsou s FISH neslučitelná:

- Bouinovo fixační činidlo
- fixační prostředek B5
- Kyselé fixační prostředky (např. kyselina pikrová)
- Zenkerův fixativ
- Alkoholy (při samostatném použití)
- Chlorid rtuťnatý
- Formaldehydové/zinkové fixační činidlo
- Hollandův fixativ
- Formalin bez pufru

9. Příprava vzorků

Připravte vzorky podle návodu k použití sady *ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit*.

10. Přípravné ošetření zařízení

Výrobek je připraven k použití. Není třeba rekonstituce, míchání ani ředění. Před použitím uveďte sondu na pokojovou teplotu (18-25 °C), chráňte před světlem. Před otevřením lahvičky promíchejte vortexováním a krátce roztočte.

11. Postup analýzy

Předúprava vzorků

Proveďte předběžnou úpravu vzorku (odvoskování, proteolýzu) podle návodu k použití sady *ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit*.

Denaturace a hybridizace

- Na každý předem ošetřený vzorek napipetujte 10 µl sondy.
- Vzorky zakryjte krycím sklíčkem o rozměrech 22 x 22 mm (zamezte zachycení bublin) a krycí sklíčko utěsněte.
- Umístejte sklíčka na horkou desku nebo hybridizátor a denaturujte vzorky po dobu 10 minut při teplotě 75 °C.
- Přeneste sklíčka do vlhké komory a hybridizujte přes noc při 37 °C (např. v hybridizační peci).

Je důležité, aby vzorky během hybridizace nevyšly.

Po hybridizaci

Zpracování po hybridizaci (promytí, protibarvení, fluorescenční mikroskopie) proveďte podle návodu k použití sady *ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit*.


12. Interpretace výsledků

Při použití vhodných sad filtrů se hybridizační signály sondy zobrazí zeleně (oblast genu MDM2) a oranžově (CEN 12).

Normální situace: V interfázích normálních buněk nebo buněk bez amplifikace zahrnující oblast genu MDM2 se objevují dva zelené a dva oranžové signály. (viz obr. 2).

Neobvyklá situace: U buněk s amplifikací oblasti genu MDM2 bude pozorován zvýšený počet zelených signálů nebo shlupek zelených signálů. (viz obr. 2).

Překrývající se signály se mohou zobrazovat jako žluté signály..

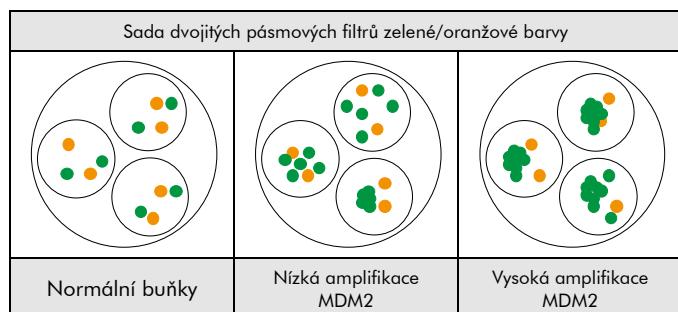

Obr. 2: Očekávané výsledky u normálních a aberantních jader

U některých abnormálních vzorků mohou být pozorovány jiné vzorce signálu, než jsou popsány výše. Tyto neočekávané vzorce signálu by měly být dále zkoumány.

Upozornění:

- Vzhledem k dekondenzovanému chromatinu se jednotlivé signály FISH mohou jevit jako malé shluky signálů. Dva nebo tři signály stejné velikosti, které jsou od sebe vzdáleny ≤ 1 průměr signálu, by se tedy měly počítat jako jeden signál.
- Nehodnoťte překrývající se jádra.
- Nepočítejte nadměrně strávená jádra (pozná se podle tmavých oblastí viditelných uvnitř jáder).
- Nepočítejte jádra se silnou autofluorescencí, která brání rozpoznání signálu.
- Negativní nebo nespecifický výsledek může být způsoben více faktory (viz kapitola 16 "Řešení problémů").
- Pro správnou interpretaci výsledků musí uživatel tento výrobek před použitím v diagnostických postupech validovat v souladu s národními a/nebo mezinárodními pokyny.

13. Doporučené postupy kontroly kvality

Aby bylo možné sledovat správnou funkčnost zpracovávaných vzorků a testovacích činidel, měla by být každá analýza doplněna interními a externími kontrolami. Pokud interní a/nebo externí kontroly neprokází odpovídající zbarvení, je třeba výsledky se vzorky pacientů považovat za neplatné.

Vnitřní kontrola: Neoplastické buňky ve vzorku, které vykazují normální vzor signálu, např. fibroblasty.

Externí ovládání: Ověřené pozitivní a negativní kontrolní vzorky.

14. Výkonnostní charakteristiky

14.1 Analytický výkon

The performance was evaluated according to the instructions for use of the ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Analytická citlivost: | 100% (95% CI 98.5 – 100.0) |
| Analytická specifitost: | 100% (95% CI 97.0 – 100.0) |

Klinický výkon

| | |
|---------------------------|---|
| Diagnostická citlivost: | ALT/WDLPs: 93.48% (95% CI 91.3 – 98.0) vs. histopatologické hodnocení 100% (95% CI 91.3 – 100.0) vs. histopatologické údaje 100% (95% CI 76.8 – 100.0) vs. histopatologické vyšetření DDLPS: 100% (95% CI 91.3 – 100.0) vs. histopatologické údaje 100% (95% CI 66.1 – 99.8) vs. mělké sekvenování celého genomu bezbuněčné DNA 94.74% (95% CI 94.3 – 97.6) vs. histopatologické vyšetření |
| Diagnostická specifitost: | ALT/WDLPs: 97.67% (95% CI 91.3 – 98.0) vs. histopatologické hodnocení 97.73% (95% CI 91.3 – 100.0) vs. histopatologické údaje 100% (95% CI 76.8 – 100.0) vs. histopatologické vyšetření DDLPS: 97.73% (95% CI 91.3 – 100.0) vs. histopatologické údaje 100% (95% CI 66.1 – 99.8) vs. mělké sekvenování celého genomu bezbuněčné DNA 100% (95% CI 94.3 – 97.6) vs. histopatologické vyšetření |

15. Likvidace

Likvidace činidel musí být prováděna v souladu s místními předpisy.

16. Řešení problémů

Jakákoli odchylka od návodu k obsluze může vést k horším výsledkům barvení nebo k tomu, že barvení nebude vůbec provedeno. Další informace naleznete na www.zytovision.com.

Slaby nebo žadny signál

| Možná příčina | Akce |
|--|--|
| Vzorek buněk nebo tkáně není správně fixován | Optimalizujte dobu fixace a fixační činidlo nebo použijte postfixační krok, jak je popsáno v "postupu analýzy" v příručce k sadě <u>ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit</u> . |
| Nesprávně provedená proteolytická předúprava | Optimalizujte dobu inkubace pepsinu, v případě potřeby ji prodlužte nebo zkrátte. |
| Odpařování sondy | Při použití hybridizátoru je použití mokrých pruhů/nádrží naplněných vodou povinné. Při použití hybridizační pece je nutné použít vlnhou komoru. Kromě toho by měl být krycí list zcela uzavřen, např. pomocí Fixogumu, aby se zabránilo vysychání vzorku během hybridizace. |
| Použití nevhodných sad filtrů | Použijte sady filtrů vhodné pro fluochromy sondy. <i>Sady říppásmových filtrů poskytují méně světla ve srovnání se sadami jednopásmových nebo dvoupásmových filtrů. V důsledku toho se signály při použití těchto sad říppásmových filtrů mohou jevit slabší.</i> |

Křízové hybridizační signály; rušivé pozadí

| Možná příčina | Akce |
|---|---|
| Nedokonalé odparafinování | Používejte čerstvé roztoky; zkontrolujte délku odparafinování |
| Příliš silná proteolytická předúprava | Zkrácení inkubační doby pepsinu |
| Sklíčka se před hybridizací ochladí na pokojovou teplotu. | Sklíčka rychle přeneste na teplotu 37 °C |

Zhoršená morfologie

| Možná příčina | Akce |
|---|--|
| Vzorek buněk nebo tkáně nebyl správně fixován | Optimalizujte dobu fixace a fixační činidlo nebo použijte postfixační krok, jak je popsáno v "postupu analýzy" v příručce k sadě <u>ZytoLight FISH-Tissue Implementation Kit</u> . |
| Nesprávně provedená proteolytická předúprava | Optimalizujte dobu inkubace pepsinu, v případě potřeby ji zkratte. |
| Nedostatečné vysušení před aplikací sondy | Prodloužení sušení na vzduchu |

Překrývající se jádra

| Možná příčina | Akce |
|----------------------------------|--|
| Nevhodná tloušťka tkáňových řezů | Příprava řezů o velikosti 2-4 µm z mikrotomu |

Vzorek vyplave ze sklíčka

| Možná příčina | Akce |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Příliš silná proteolytická předúprava | Zkrácení inkubační doby pepsinu |

Slabá protibarva

| Možná příčina | Akce |
|----------------------------------|--|
| Nízkokoncentrovaný roztok DAPI | Místo toho použijte roztok <u>DAPI/DuraTect-Solution (ultra)</u> (prod. č. MT-0008-0.8). |
| Příliš krátká doba inkubace DAPI | Úprava doby inkubace DAPI |

17. Literatura

- Kammerer-Jacquet S-F, et al. (2017) *Hum Pathol*.
- Kashima T, et al. (2012) *Mod Pathol*.
- Kievits T, et al. (1990) *Cytogenet Cell Genet* 53: 134-6.
- Wilkinson DG: *In Situ Hybridization, A Practical Approach*, Oxford University Press (1992) ISBN 0 19 963327 4.

18. Revizewww.zytovision.com

Nejnovější návod k použití a návod k použití v různých jazycích naleznete na adrese www.zytovision.com.

Naši odborníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy.

Kontaktujte prosím helptech@zytovision.com

Shrnutí bezpečnosti a výkonnosti naleznete na stránce www.zytovision.com.



ZytoVision GmbH

Fischkai 1

27572 Bremerhaven/ Německo

Telefon: +49 471 4832-300

Fax: +49 471 4832-509

www.zytovision.com

E-mail: info@zytovision.com

Ochranné známky:

ZytoVision® a ZytoLight® jsou ochranné známky společnosti ZytoVision GmbH.